




# ГРУППА ЗАПОЛНЕНИЯ

## 146SM Группа заполнения без манометра

### ИНСТРУКЦИИ

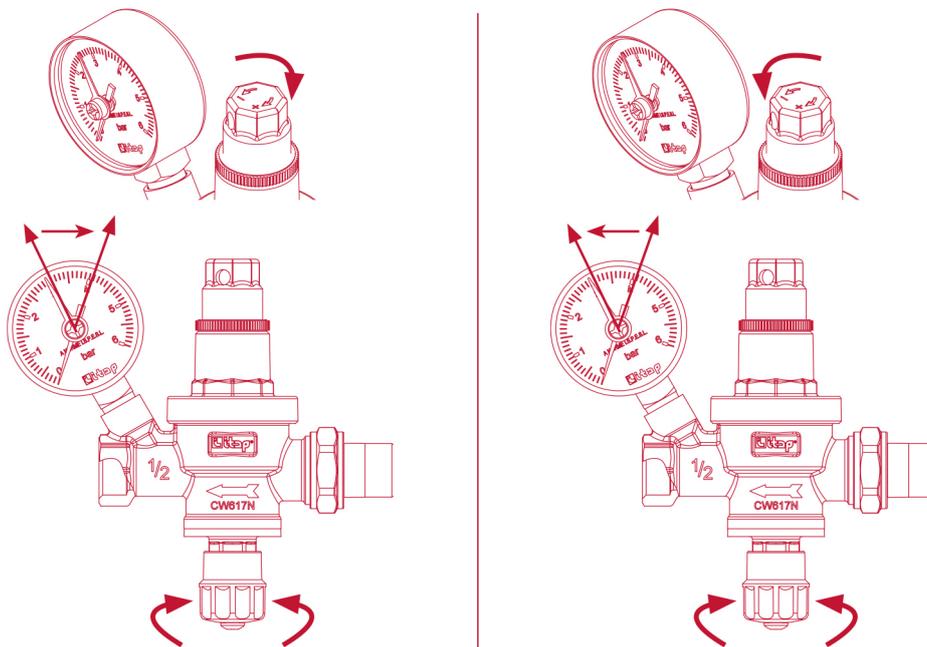

Pre-set = 1,5 bar